

Impact des objets présents dans l'overranging sur la modulation d'intensité : comparaison inter-scanner

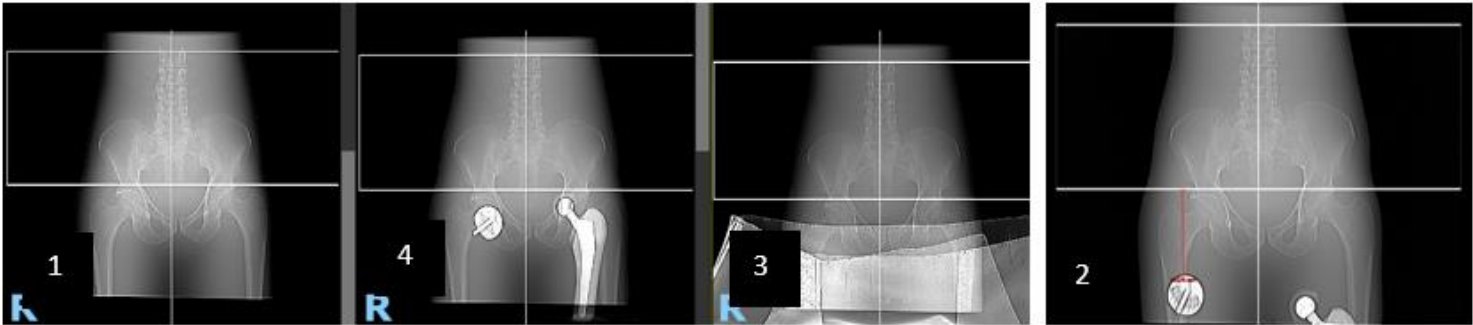


Image 1 : 4 boîtes d'acquisitions réalisées sur le scanner A. Acquisitions 1 et 4 réalisées sur les scanner B et C également

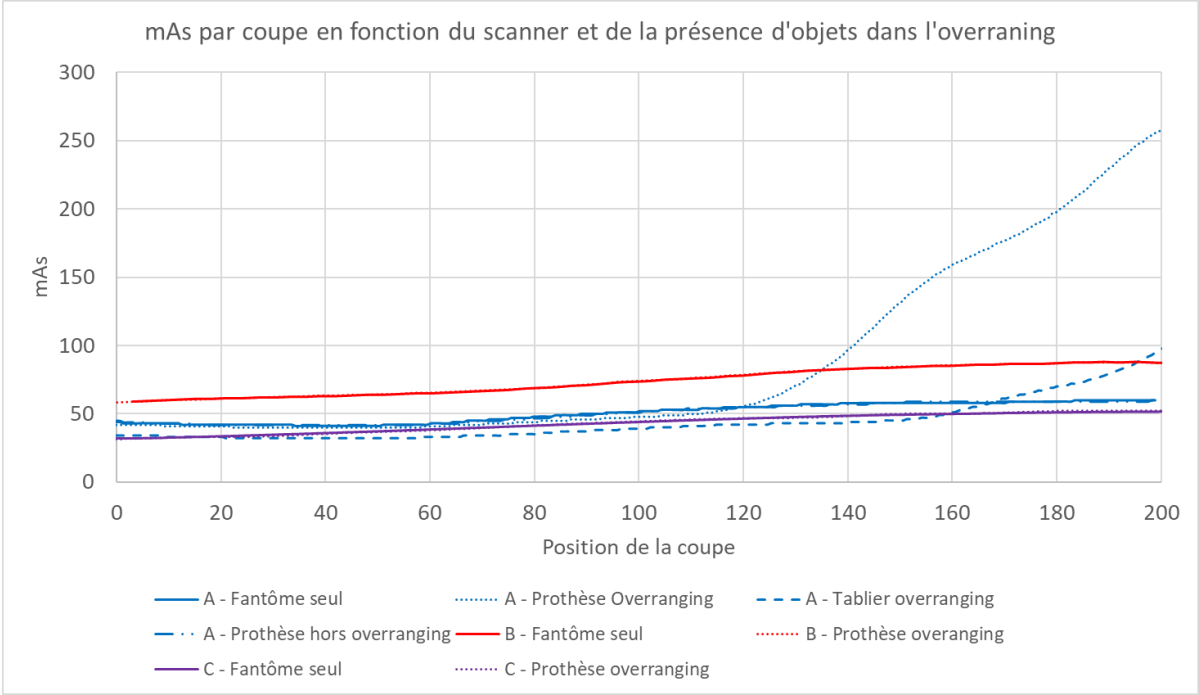


Image 2 : Graphique des mAs par coupe pour les acquisitions réalisées sur les scanners A, B et C

Acquisition	CTDI (mGy)
A - Fantôme seul	4
A - Prothèse Overranging	9,1
A - Tablier overranging	5,4
A - Prothèse hors overranging	4
B - Fantôme seul	8,26
B - Prothèse overranging	8,26
C - Fantôme seul	3,36
C - Prothèse overranging	3,34

Tableau 1 : CTDI en mGy pour les acquisitions réalisées sur les scanners A, B et C